



TOYOTA HIACE 2700 CC

AMBULANCE TOYOTA HIACE 2026



PASMED 



TOYOTA

TOYOTA HIACE 2700 CC

AMBULANCE TOYOTA HIACE 2026



PASMED 



TOYOTA HIACE 2700 CC

AMBULANCE TOYOTA HIACE 2026





TOYOTA HIACE 2700 CC

AMBULANCE TOYOTA HIACE 2026



دفترچه راهنما مالک آمبولانس تویوتا هایس (۲۷۰۰ سی سی)

Toyota Hiace Ambulance (2700 cc) Owner's Manual

دفترچه راهنمای استفاده از آمبولانس تویوتا هایس (۲۷۰۰ سی سی) ب منظور آشنایی کاربران محترم با تجهیزات و قسمت های مختلف آمبولانس تجهیز شده توسط شرکت نیما پ . آ . س تهیه شده است ، خواهشمند است این دفترچه را جهت استفاده صحیح ، موثر و کارآمد از امکانات تعبیه شده در آمبولانس ، به طور کامل مطالعه فرمایید .



This user manual for the Toyota Hiace (2700cc) ambulance has been prepared by Nima P.A.S. Company to familiarize users with the vehicle's equipment and various sections. Please read this manual thoroughly to ensure the correct, effective, and efficient use of the ambulance's installed features.

ردیف :	مشخصات کلی :	General Specifications:	ROW
۱	ورودی کابین بیمار	Patient cabin entrance	1
۲	معرفی بخش های مختلف کابین بیمار	Introduction to the various sections of the patient cabin	2
۳	سایر تجهیزات قابل سفارش بر اساس نیاز مشتری	Other equipment available for order based on customer requirements	3
۴	محل نصب و استقرار تجهیزات پزشکی کابین بیمار	Installation and mounting location for medical equipment in the patient cabin.	4
۵	سیستم کنترل الکترونیکی	Electronic control system	5
۶	سیستم روشنایی	Lighting system	6
۷	سیستم تهویه	Ventilation system	7
۸	سیستم گرمایش و سرمایش کابین بیمار	Patient compartment heating and cooling system	8
۹	سیستم اکسیژن تراپی	Oxygen therapy system	9
۱۰	صندلی تکنسین و همراه بیمار	Technician and Patient Companion Chair	10
۱۱	آویز سرم	IV stand	11
۱۲	آلارم، آژیر، سیرن و آمپلی فایر	Alarms, sirens, sirens and amplifiers	12
۱۳	سیستم ارتباطی کابین عقب بیمار با کابین جلو	Communication system between the patient's rear compartment and the front cabin.	13
۱۴	نکات ایمنی و نگهداری	Safety and Maintenance Instructions	14
۱۵	ضمانت و خدمات پس از فروش	Warranty and After-Sales Service	15

ردیف :	مشخصات فنی :	Technical Specifications:	ROW
۱	مدل موتور : 1KD-FTV	Engine Model: 1KD-FTV	1
۲	حجم موتور : ۲۶۹۴ سی سی	Engine displacement: 2,694 cc	2
۳	گیربکس: ۵ دنده دستی	Transmission: 5-speed manual	3
۴	حداکثر قدرت موتور (اسب بخار / دور بر دقیقه) : ۱۴۹/۴۸۰۰	Maximum engine power (hp / rpm): 149 / 4,800	4
۵	استاندارد آلایندگی : یورو ۴	Emission standard: Euro 4	5
۶	تعداد سوپاپ : ۱۶	Number of valves: 16	6
۷	تعداد سیلندر : ۴	Number of cylinders: 4	7
۸	حداکثر گشتاور موتور (نیوتون متر / دور بر دقیقه) : ۲۴۱/۴۸۰۰	Maximum engine torque (N-m / rpm): 241 / 4800	8
۹	حجم باک سوخت : ۷۰ لیتر	Fuel tank capacity: 70 liters	9
۱۰	نوع سوخت : بنزین	Fuel type: petrol	10
۱۱	مصرف سوخت ترکیبی : ۱۱/۶ لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر	Combined fuel consumption: 11.6 liters per 100 kilometers	11
۱۲	شتاب صفر تا صد : ۱۷ ثانیه	0-100 km/h acceleration: 17 seconds	12
۱۳	حداکثر سرعت : ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت	Top speed: 170 km/h	13

۱- پروژکتور

۲- هواکش سقفی

۳- سانترال اکسیژن

۴- محل قرار گیری کپسول اکسیژن

۵- چراغ سقفی

۶- دستگیره

۷- صندلی همراه بیمار

۸- چکش شیشه شکن

۹- صندلی تکنسین

۱۰- ونتیلاتور

۱۱- برانکارد

۱۲- کپسول آتش نشانی



- y glass-breaking hammer
seat



۱۳- کنترل پنل و سیستم اینورتر

۱۴- مانومتر اکسیژن

۱۵- سیستم گرمایش و سرمایش

۱۶- فشار سنج دیواری

۱۷- ساکشن

۱۸- مانیتور علائم حیاتی

۱۹- پمپ سرنگ

۲۰- محل قرار گیری برانکارد صندلی شونده (چیر استریجر)



13- Control panel and inverter system

14- Oxygen regulator/gauge

15- Heating and cooling system

16- Wall-mounted pressure gauge

17- Suction unit



18- Vital signs monitor

19- Syringe pump

20- Location for convertible stretcher (chair-stretcher)

PASMO



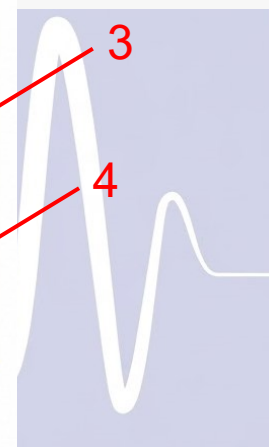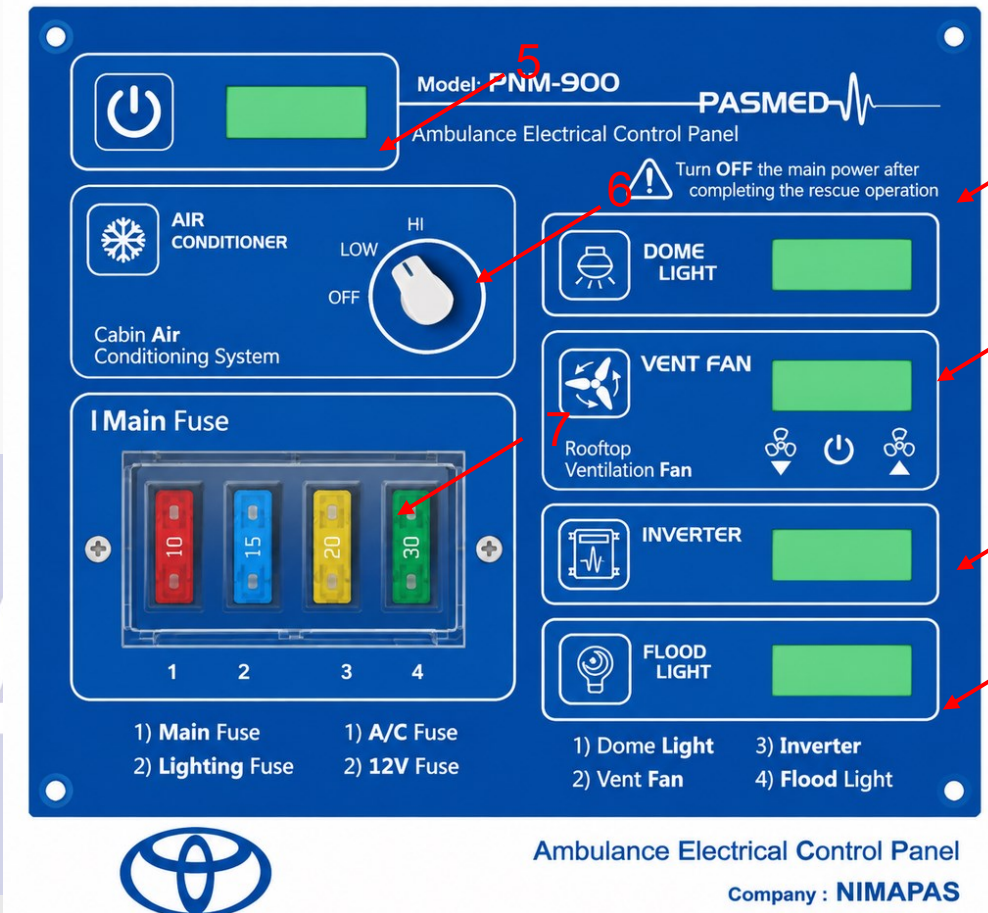

Ambulance Control Panel:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1- Ceiling light | 6- Heater and A/C system |
| 2- Ventilation fan | 7- Patient compartment fuse system |
| 3- Inverter | |
| 4- Floodlight | |
| 5- On/Off | |

کنترل پنل آمبولانس :

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| ۱- چراغ سقف | ۶- سیستم بخاری و کولر |
| ۲- فن تهویه | ۷- سیستم فیوز های کابین بیمار |
| ۳- اینورتر | |
| ۴- نور افکن | |
| ۵- روشن / خاموش | |

نکات ایمنی و نگهداری :

بررسی های مورد نیاز قبل از اعزام آمبولانس :

بررسی روزانه و آماده سازی کامل آمبولانس شامل بررسی تجهیزات می گردد . این بازبینی به این جهت است که مطمئن شوید همه چیز در جای خود قرار گرفته و در دسترس است . به این منظور موارد زیر را باید در آمبولانس بررسی کنید :

سیستم خنک کننده ، میزان سوخت ، سطح روغن موتور ، میزان مایع جعبه دنده ، روغن ترمز ، تسمه موتور ، تمام چراغ های داخلی و خارجی ، برف پاک کن شیشه جلو و مایع آن ، بوق ، فشار باد چرخ ها و لاستیک زاپاس ، آژیر و آلارم های سقفی ، سیستم سرمایشی و گرمایشی ، سیستم تهویه ، درب ها ، بی سیم های دستی و ثابت کلیه تجهیزات ، ملزومات پزشکی شامل کپسول های اکسیژن ، کیف احیاء ، اسپلینت ، پانسمان و باند ها ، لانگ بک بوردها ، و دیگر تجهیزات ثابت سازی بیمار و کیت اورژانسی زایمان را به صورت روزانه چک کنید . همه تجهیزاتی که با باتری کار می کنند مانند ساکشن و دفیبریلاتور ، باید روزانه آزمایش شوند . طی این بررسی متوجه می شوید که آیا تجهیزات به درستی عمل می کنند ؟ آیا ملزومات تمیز و استریل هستند ؟ آیا به مقدار کافی موجود هستند ؟

Safety and Maintenance Guidelines:

Pre-dispatch Checks:

Daily inspection and full preparation of the ambulance include checking the equipment. This review ensures that everything is in its proper place and readily accessible. To this end, you must check the following items in the ambulance:

Check the following items daily: cooling system, fuel level, engine oil level, transmission fluid level, brake fluid, engine belts, all interior and exterior lights, windshield wipers and fluid, horn, tire pressure (including the spare), siren and roof-mounted warning lights, heating and cooling systems, ventilation system, doors, and all portable and fixed two-way radios. Also, check medical supplies—including oxygen cylinders, resuscitation kits, splints, dressings and bandages, long backboards, other patient immobilization equipment, and emergency childbirth kits—on a daily basis. All battery-operated equipment, such as suction units and defibrillators, must be tested daily. During these checks, verify whether the equipment is functioning correctly, and ensure that supplies are clean, sterile, and adequately stocked.

مرحله آمادگی :

وسایل و تجهیزات پزشکی در آمبولانس بر طبق ضرورت و میزان نیازی که به آن خواهیم داشت ذخیره کنید .

اولویت به اقلامی بدهید که در هنگام خطر مرگ بیمار برای مراقبت لازم است . تجهیزات کنترل راه هوایی ، تنفس مصنوعی و اکسیژن رسانی از آن جمله اند . این اقلام را در

کابینت دارو و تجهیزات کنار صندلی تکنسین قرار دهید تا به راحتی در دسترس باشند .

تجهیزات مربوط به مراقبت های قلبی ، پانسمان ، بخیه و کنترل فشار خون را در کنار برانکارد قرار دهید .

در قسمت جلوی کابینت ها و کشو ها برچسب بزنید تا بتوانید به سرعت محتویات آن را تشخیص داده و استفاده کنید .

در هنگام حرکت آمبولانس کمر بند ایمنی خود و بیمار را ببندید .



Preparation phase:

Stock the ambulance with medical supplies and equipment based on necessity and anticipated needs.


Prioritize items essential for patient care during life-threatening situations, such as equipment for airway management, artificial respiration, and oxygen delivery.

Place these items in the cabinet next to the technician's seat so they are easily accessible.

Position equipment for cardiac care, wound dressing, suturing, and blood pressure monitoring near the stretcher.

Label the fronts of cabinets and drawers to allow for quick identification and use of their contents.

Fasten your seatbelt and the patient's seatbelt while the ambulance is in motion.

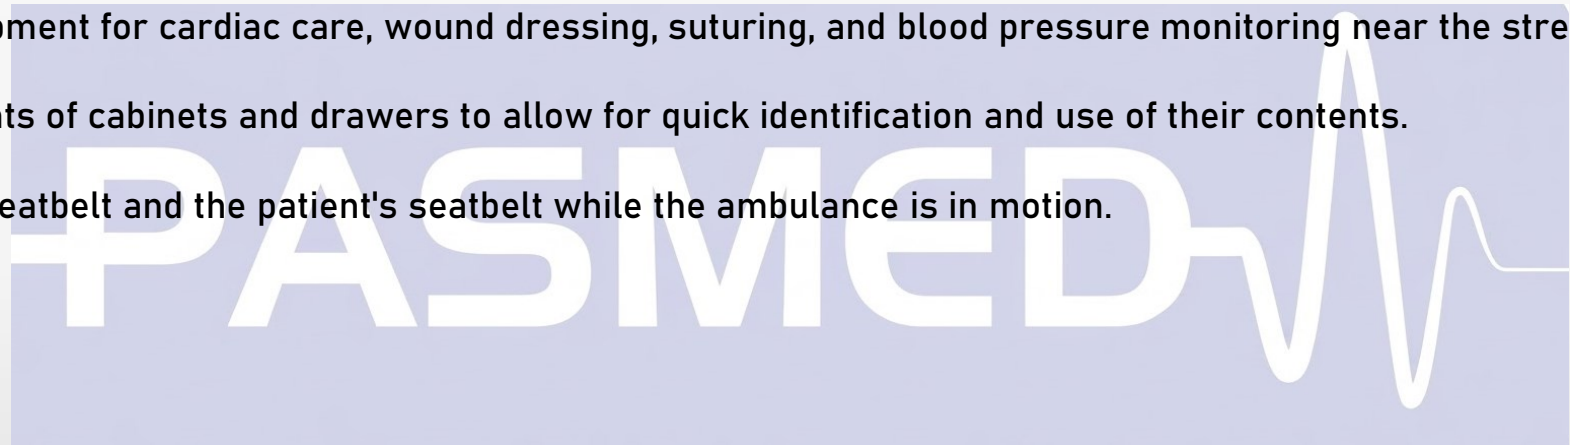

ضمانت و خدمات پس از فروش :

مشتری گرامی :



علامت تجاری ثبت شده محصولات انحصاری شرکت نیما پ . آ . س می باشد محصولات دارای این نشان مطابق با تاریخ فاکتور فروش مدت زمان

گارانتی محصول ، مشمول خدمات پس از فروش شرکت نیما پ . آ . س می باشند . این علامت تجاری در حال حاضر به دلیل کیفیت بالای محصولات و خدمات ارائه شده

از اعتبار قابل توجهی در ایران برخوردار است .

استقرار سیستم رسیدگی به امور مشتریان در شرکت نیما پ . آ . س بر اساس استاندارد های بین المللی ISO 1002:2004 امکان پاسخگویی به کلیه درخواست های مشتریان گرامی را فراهم می سازد .

مراحل بهره مندی از خدمات پس از فروش شرکت نیما . پ . آ . س :

۱- تماس با امور مشتریان شرکت نیما پ . آ . س :

تلفن : ۰۲۱-۶۶۱۷۴۷۲۱ 

تلفن : ۰۲۱-۶۶۱۷۴۷۱۵ 

فکس : ۰۲۱-۶۶۱۷۴۸۶۴ 

موبایل : ۰۹۱۰۴۱۵۹۱۷۶ 

Warranty and After-Sales Service:

Dear Customer: 

The registered trademark belongs exclusively to Nima P.A.S. Company. Products bearing this mark are covered by Nima P.A.S. after-sales services for the duration of the warranty period, calculated from the date of the sales invoice. Thanks to the high quality of the products and services provided, this trademark currently enjoys significant prestige in Iran.

Nima P.A.S. Company is equipped to address all customer-related inquiries in accordance with international standards, specifically the ISO 1002:2004 standard for customer complaint handling systems.

Steps to access Nima P.A.S. Company's after-sales services:

1- Contact Nima P.A.S. Company Customer Service:

 Tel: 021-66174721

 Tel: 021-66174715

 Fax: 021-66174864

 Mobile: 09104159176

۲- تعیین وقت رسیدگی :

کلیه درخواست ها در نخستین فرصت و کمترین زمان ممکن توسط کارشناسان بررسی می گردد و جهت تعیین وقت ، اعزام به دفتر مرکزی یا کارخانه ، با مشتری تماس گرفته خواهد شد .

۳- اقدامات واحد فنی امور مشتریان :

کارشناسان مجرب واحد فنی امور مشتریان با بررسی و عیب یابی کامل محصول ارائه شده در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به رفع عیب قید شده در ، درخواست مشتریان و نیز سایر عیوب احتمالی نموده و محصول مجدداً توسط واحد کنترل کیفیت شرکت از نظر کارایی موارد ارزیابی و تست های تخصصی قرار خواهد گرفت تا محصول با کیفیت اولیه در اختیار مشتری قرار گیرد .

۴- بازگشت محصول :

واحد امور مشتریان نسبت به انجام هماهنگی های لازم جهت بازگشت محصول به مشتری در اسرع وقت اقدام خواهد نمود .

۵- ارزیابی کیفی خدمات ارائه شده :

میزان رضایتمندی شما از کیفیت و سرعت خدمات ارائه شده توسط واحد خدمات پس از فروش ، از اولویت های شرکت نیما پ . آ . س می باشد .

2- Scheduling the Service Appointment:

All requests are reviewed by specialists at the earliest opportunity. The customer will be contacted to schedule an appointment or arrange for the product to be sent to the head office or factory.

3- Actions Taken by the Technical Customer Service Unit:

Experienced specialists in the Technical Customer Service Unit will conduct a thorough inspection and troubleshooting of the product. They will promptly resolve the issue reported by the customer as well as any other potential defects. Subsequently, the product will undergo performance evaluations and specialized testing by the company's Quality Control Unit to ensure it is returned to the customer with its original quality standards.

4- Product Return:

The Customer Affairs Department will make the necessary arrangements to return the product to the customer as soon as possible.

5- Quality Assessment of Services Provided:

Your satisfaction with the quality and speed of the services provided by the After-Sales Service Department is a priority for Nima P.A.S. Company.



تایم کاری :

مشتریان محترم :

شرکت نیما پ . آ . س از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۷:۰۰ می باشد آماده ی پاسخگویی به کلیه ی درخواست های شما می باشد .

خواهشمند است مارا از نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود بهره مند سازید .

Business Hours:

Dear Customers,

Nima P.A.S. Company is available to address all your inquiries from Saturday to Thursday, between 8:30 AM and 5:00 PM.

We welcome your comments, suggestions, and feedback.

باتشکر ، شرکت خرید و فروش ، تجهیز و کاربری سازی نیما پ . آ . س

Sincerely, Nima P.A.S. Company (Trading, Equipping, and Custom Outfitting)

PASMED